

医療機器ベンチャー×モノづくりマッチング商談会

株式会社S.H.Iバイオとの商談会

今般、メディカル・デバイス産業振興協議会では、名古屋産業科学研究所 中部TLOとの共催により「新たに医療機器開発に取り組むベンチャー企業」と「中小モノづくり企業」とのビジネスマッチングを提供する商談会を開催致します。

商談のミスマッチを防ぐため、お申込み情報を基に、事前にスクリーニングを行うことで、具体的で、確度の高い商談が可能です。

加えて、中部TLOに所属する医療機器開発の専門家と名古屋商工会議所「医療機器産業参入サポートデスク」のコーディネーターが同席し、商談と商談後のサポートをさせていただきます。

新たな取引先の開拓をめざす中小モノづくり企業の皆さま方のご参加をお待ちしています！

（株）S.H.Iバイオ

現状の医療機器の課題解決のために 2020 年に設立したベンチャーです。現役の臨床医／外資系大手医療機器メーカーでの臨床開発、薬事経験者／大手医療機器メーカーでの営業経験者の3名が心疾患の医療機器開発に取り組んでいます。
本社所在地は京都府相楽郡。

中部 TLO

2000年に大学技術移転機関として設立。2021年度より日本医療研究開発機構（AMED）の医工連携イノベーション推進事業（地域連携自立化推進事業）に採択され、ヘルスケア・医療機器産業基盤構築に取り組んでいます。

日 時 2022年9月20日（火）10時～17時

※上記時間の中で商談をセッティングします。（一商談：25分）

会 場 名古屋商工会議所 会議室

主 催 メディカル・デバイス産業振興協議会、名古屋産業科学研究所 中部 TLO

参加企業 株式会社 S.H.I バイオ（医療機器製造業、ISO13485 保有）

求める技術 直径 0.3mm の針金状の合金を覆うチューブ状のポリエステルカバーを編む技術

今回開発する医療機器は、クラスIVで、至近のターゲット市場規模は、30-40億円を想定。

取引条件 ①大手繊維メーカーとの取引実績があること

②医療機器等製造業許可を有するか、将来取得する予定であること。

（来年度 PMDA*1 と FDA*2 へ申請をする予定です。）

*1 PMDA…独立行政法人 医薬品医療機器総合機構。厚生労働省所管の独立行政法人で、薬機法に基づく医薬品・医療機器などの承認審査関連業務などを行う。

*2 FDA…アメリカ食品医薬品局。連邦食品・医薬品・化粧品法に基づく医療機器等の許可や取り締まりを行う。

募集企業数 10社程度※どの企業様もご応募いただけます

参加費 無 料

申し込み <https://answer.cci.nagoya/mono/?code=4af9d4e0>

コチラからも申込
いただけます→




申込期限 2022年9月5日（月）

お問合せ：名古屋商工会議所 モノづくりユニット 担当：名畑

〒460-8422 名古屋市中区栄 2-10-19 TEL:052-223-6748 FAX:052-232-5752 E-mail:medical-device@nagoya-cci.or.jp

※裏面もご確認ください

参加申込から商談会当日までの流れ

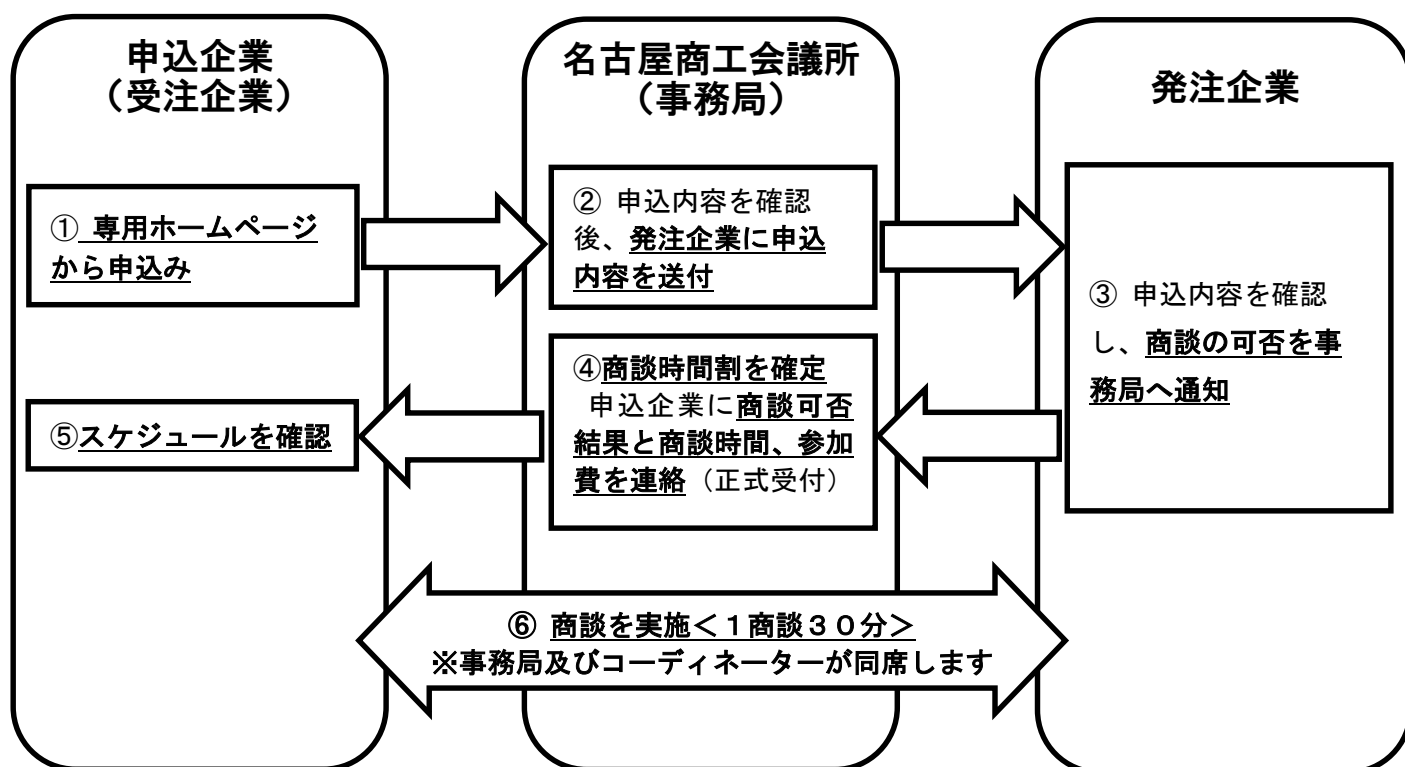

<お願い>

- ① 内容により商談のご希望に沿えない場合がございますことを予めご了承ください。
- ② 正式受付(商談の可否の連絡時)以降のキャンセルはご遠慮下さい。
- ③ 開催一週間前までに本所から連絡のない場合は、お手数ですが担当までご連絡下さい。

注意事項／<商談について> ●受注企業の参加申込書の記載内容などをもとに、発注企業と事務局にて相談の上、商談の可否を決定します。内容により商談のご希望に沿えない場合がございますことを予めご了承ください。 ●商談・契約は当事者間（発注側、受注側参加企業の双方）の責任で行っていただきます。 ●当日の商談は発注案件に関するものに限らせていただきます。発注案件に関わりのない売り込みはご遠慮ください。 ●発注案件の内容などに関するお問い合わせにつきましては、記載されている範囲を超えてお答えできません。また、発注側参加企業への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 ●正式受付後（商談の可否と商談時間、参加費の連絡時）のキャンセルはご遠慮下さい。 ●開催一週間前までに当所から連絡のない場合は、お手数ですが担当までご連絡下さい。

<個人情報の取り扱いについて>当商談会の参加申込みの際にご入力いただいた個人情報につきましては、当事業の実施・運営のために利用するほか、名古屋商工会議所が実施する各種事業の企画・案内・情報提供に利用することがあります。

お問合せ：名古屋商工会議所 モノづくりユニット 担当：名畑

〒460-8422 名古屋市中区栄 2-10-19 TEL:052-223-6748 FAX:052-232-5752 E-mail:medical-device@nagoya-cci.or.jp